



TRANSKUTANER SCHRITTMACHER



INDIKATION

Instabilität bei Bradykardie

- Vigilanzminderung
- Schock
- Myokardiale Ischämie
- akut dekompensierte Herzinsuffizienz

Beachte Ursachen für instabile Bradykardie:


- Höhergradige AV-Blöcke
- Myokardinfarkt
- Hyperkaliämie
- Intoxikationen

PLATZIERUNG DER PATCHES

Anterior
Posterior

Alternativ:
Anterolateral

Extremitätenableitung zwingend notwendig

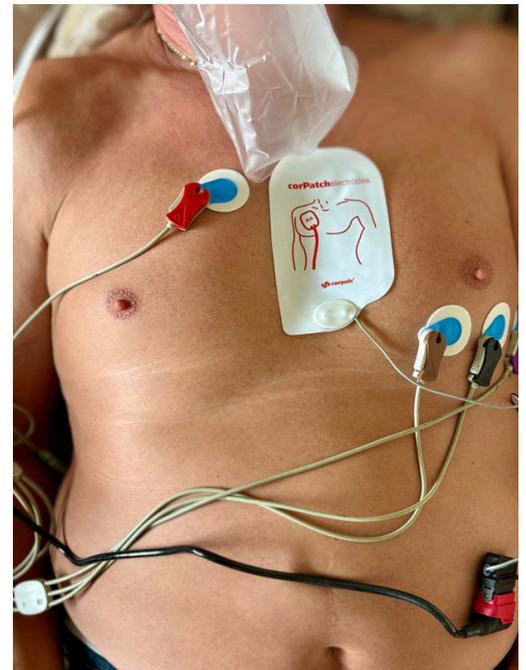


EINSTELLUNGEN - START DEMAND-MODUS

80
mA

70
Frequenz

ANTWORT DES PATIENTEN

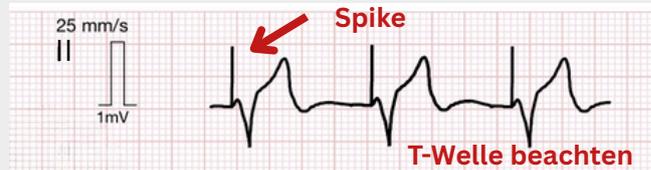

Unbedingt ventrikulären Auswurf bewerten (Leistenpuls tasten) und C dauerhaft beurteilen

Nutze etCO₂ für eine ausreichende Perfusionskontrolle

GENAUE ADAPTION

Schrittweise bis Reizschwelle mA erhöhen bzw reduzieren.

+ 10 mA oberhalb der Reizschwelle

Bedenke Transport und Umlagerungen - ggf. weitere Adaptionen notwendig!

ATEM - Advanced Training for and from Emergency Medicine
Stand: 04/2025 www.atem-life.de